


Манометры газовые грузопоршневые МГП



МГП-100

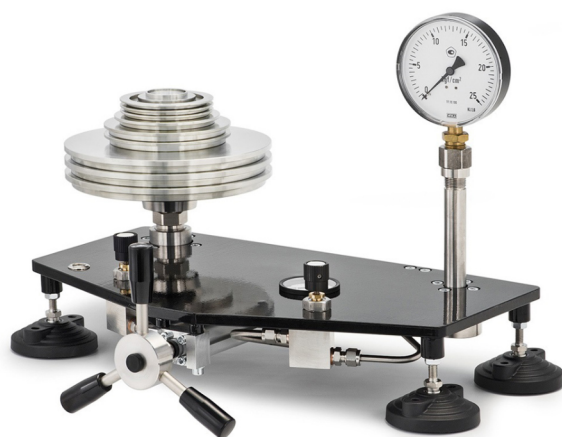

МГП-10

Назначение

Поверка и калибровка средств измерения избыточного давления: калибраторов давления, измерительных преобразователей давления (датчиков), образцовых и технических манометров, грузопоршневых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне от -0,1 до 16 МПа.

Поверка и калибровка средств измерения давления, не допускающих попадания внутрь жидкостей, в том числе кислородного исполнения.

Замена устаревших манометров грузопоршневых с низким пределом измерения, давления, таких как Воздух, МП-2.5, МВП-2.5, МП-6 и прочих

Преимущества

- Модификации с ВПИ до 50 кПа для поверки низкопределных датчиков давления – уникальный диапазон для грузопоршневой манометрии.
- Возможность комплектации одного устройства для создания давления (УСД) несколькими измерительными поршневыми системами (ИПС) для расширения диапазона измерений.
- Рабочая среда – воздух или азот.
- В стандартном исполнении встроенный ручной насос и объемный регулятор для создания тестового давления в диапазоне от -0,095 до 1 МПа¹, возможность подключения внешних источников создания давления и разряжения (баллон с азотом, вакуумный насос) с управлением высокоточными вентилями.
- Опционально оснащается устройством электропривода вращения поршня ИПС для облегчения работы и увеличения срока службы прибора.
- Возможность поверки грузопоршневых манометров уже в стандартном исполнении.
- Измерительная поршневая система (ИПС) из карбида вольфрама для значительного снижения (в 4 раза) влияния измерения температуры на результаты измерений, увеличения долговременной стабильности, износостойкости и долговечности прибора.
- Грузы выполнены из нержавеющей немагнитной стали.
- Улучшенные эргономические особенности, уменьшенные массогабаритные характеристики.

¹ – кроме МГП-100.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

	МГП-В	МГП-0,2	МГП-0,5	МГП-1	МГП-2,5	МГП-4	МГП-10	МГП-25	МГП-100	МГП-160
Диапазон измерения, МПа	-0,003...-0,1	0,0007...0,02	0,0007...0,05	0,003...0,1	0,003...0,25	0,003...0,4	0,02...1	0,02...2,5	0,04...10	0,04...16
Класс точности ¹	0,005; 0,01; 0,02; 0,05									
Дискретность создания давления, обеспечиваемая стандартным набором грузов, кПа	1	0,1	0,1	1	1	1	5	5	25	25
Единицы измерения давления доступные при заказе ²	МПа, кгс/см ² , бар и т.д.									
Масса прибора без комплекта грузов, кг	14	20	20	14	14	14	14	14	14	14
Рабочая среда	Воздух или азот									
Номинальная площадь поршня, см ²	5	25	25	5	5	5	1	1	0,2	0,2
Грузы с номинальной массой в стандартной поставке, шт, и создаваемое давление:										
0,025 кг	—	1 (0,1 кПа)	1 (0,1 кПа)	—	—	—	—	—	—	—
0,04 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (20 кПа)	1 (20 кПа)
0,05 кг	1 (-1 кПа)	2 (0,2 кПа)	2 (0,2 кПа)	1 (1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (5 кПа)	1 (5 кПа)	1 (25 кПа)	1 (25 кПа)
0,08 кг	—	—	—	—	—	—	—	—	1 (40 кПа)	1 (40 кПа)
0,1 кг	2 (-2 кПа)	—	—	2 (2 кПа)	2 (2 кПа)	2 (2 кПа)	1 (10 кПа)	1 (10 кПа)	1 (50 кПа)	1 (50 кПа)
0,125 кг	—	1 (0,5 кПа)	1 (0,5 кПа)	—	—	—	—	—	—	—
0,2 кг	—	—	—	—	—	—	2 (20 кПа)	2 (20 кПа)	2 (100 кПа)	2 (100 кПа)
0,25 кг	1 (-5 кПа)	4 (1 кПа)	4 (1 кПа)	1 (5 кПа)	1 (5 кПа)	1 (5 кПа)	—	—	—	—
0,5 кг	8 (-10 кПа)	—	—	8 (10 кПа)	2 (10 кПа)	2 (10 кПа)	1 (50 кПа)	1 (50 кПа)	1 (250 кПа)	1 (250 кПа)
1,0 кг	—	—	—	—	11 (20 кПа)	2 (20 кПа)	9 (100 кПа)	4 (100 кПа)	3 (500 кПа)	3 (500 кПа)
1,250 кг	—	3 (5 кПа)	1 (5 кПа)	—	—	—	—	—	—	—
2,0 кг	—	—	—	—	—	8 (40 кПа)	—	10 (200 кПа)	8 (1000 кПа)	14 (1000 кПа)
2,5 кг	—	—	4 (10 кПа)	—	—	—	—	—	—	—
ИПС	1 (-3 кПа)	1 (0,7 кПа)	1 (0,7 кПа)	1 (3 кПа)	1 (3 кПа)	1 (3 кПа)	1 (20 кПа)	1 (20 кПа)	1 (40 кПа)	1 (40 кПа)
Колокол	—	—	—	1 (17 кПа)	1 (17 кПа)	1 (17 кПа)	1 (80 кПа)	1 (80 кПа)	1 (460 кПа)	1 (460 кПа)
Тарелка	1 (-7 кПа)	1 (0,3 кПа)	1 (0,3 кПа)	1 (1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (5 кПа)	1 (5 кПа)	1 (20 кПа)	1 (20 кПа)

¹ В основном диапазоне измерений от $0,1 \cdot P_{\max}$ до $P_{\max}$ погрешность нормируется в % от измеряемой величины; в дополнительном диапазоне измерений от $P_{\min}$ до $0,1 \cdot P_{\max}$ погрешность нормируется в % от $0,1 \cdot P_{\max}$ (где $P_{\max}$ — верхний предел диапазона измерений; $P_{\min}$ — нижний предел диапазона измерений.)

² Возможно заказать прибор с несколькими наборами грузов в различных единицах измерения.




Основные технические и эксплуатационные характеристики: Комбинированные модификации «давление-вакуум»

	МГП-В-2,5		МГП-В-4		МГП-В-10					
Диапазон измерения, МПа	-0,003...-0,1; 0,003...0,25		-0,003...-0,1; 0,003...0,4		-0,003...-0,1; 0,02...1					
Класс точности ¹	0,005; 0,01; 0,02; 0,05		0,005; 0,01; 0,02; 0,05		0,005; 0,01; 0,02; 0,05					
Дискретность создания давления, обеспечиваемая стандартным набором грузов, кПа	1		1		1;5					
Единицы измерения давления доступные при заказе ²	МПа, кгс/см², бар и т.д.		МПа, кгс/см², бар и т.д.		МПа, кгс/см², бар и т.д.					
Масса прибора без комплекта грузов, кг	14		14		14					
Рабочая среда	Воздух или азот		Воздух или азот		Воздух или азот					
Номинальная площадь поршней, см²	5		5		5; 1					
Грузы с номинальной массой в стандартной поставке, шт, и создаваемое давление:										
0,025 кг	—	—	—	—	—	—				
0,04 кг	—	—	—	—	—	—				
0,05 кг	1 (-1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (-1 кПа)	1 (1 кПа)	1 (-1 кПа)	1 (5 кПа)				
0,08 кг	—	—	—	—	—	—				
0,1 кг	2 (-2 кПа)	2 (2 кПа)	2 (-2 кПа)	2 (2 кПа)	2 (-2 кПа)	1 (10 кПа)				
0,125 кг	—	—	—	—	—	—				
0,2 кг	—	—	—	—	—	2 (20 кПа)				
0,25 кг	1 (-5 кПа)	1 (5 кПа)	1 (-5 кПа)	1 (5 кПа)	1 (-5 кПа)	—				
0,5 кг	8 (-10 кПа)	2 (10 кПа)	8 (-10 кПа)	2 (10 кПа)	8 (-10 кПа)	1 (50 кПа)				
1,0 кг	—	11 (20 кПа)	—	2 (20 кПа)	—	9 (100 кПа)				
1,250 кг	—	—	—	—	—	—				
2,0 кг	—	—	—	8 (40 кПа)	—	—				
ИПС	1 (-3 кПа)	1 (3 кПа)	1 (-3 кПа)	1 (3 кПа)	1 (-3 кПа)	1 (20 кПа)				
Колокол	—	1 (17 кПа)	—	1 (17 кПа)	—	1 (80 кПа)				
Тарелка	1 (-7 кПа)	1 (1 кПа)	1 (-7 кПа)	1 (1 кПа)	1 (-7 кПа)	1 (5 кПа)				




¹ В основном диапазоне измерений от $0,1 \cdot P_{\max}$ до $P_{\max}$ погрешность нормируется в % от измеряемой величины; в дополнительном диапазоне измерений от $P_{\min}$ до $0,1 \cdot P_{\max}$ погрешность нормируется в % от $0,1 \cdot P_{\max}$ (где $P_{\max}$ — верхний предел диапазона измерений; $P_{\min}$ — нижний предел диапазона измерений.)

² Возможно заказать прибор с несколькими наборами грузов в различных единицах измерения.

МГП-В...10

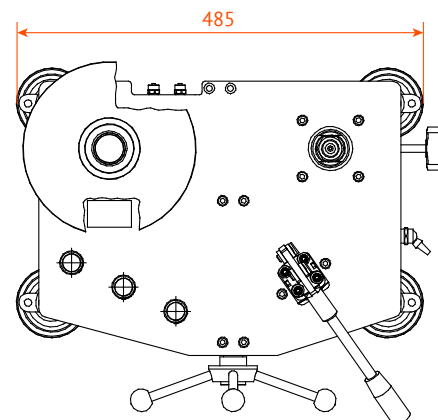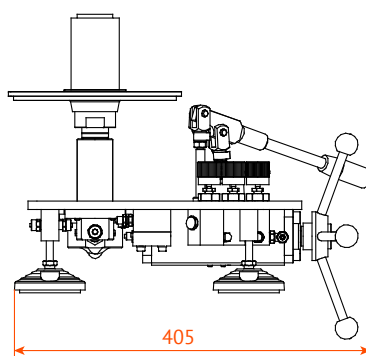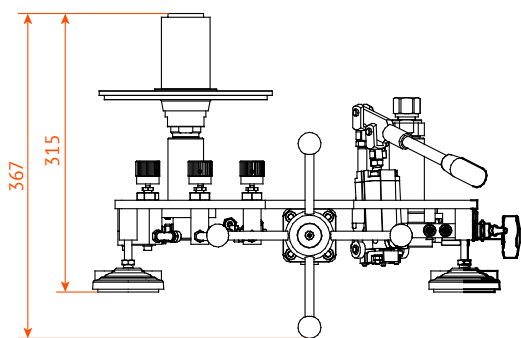

МГП-25...160

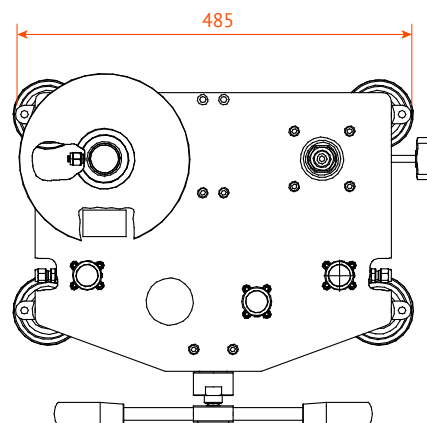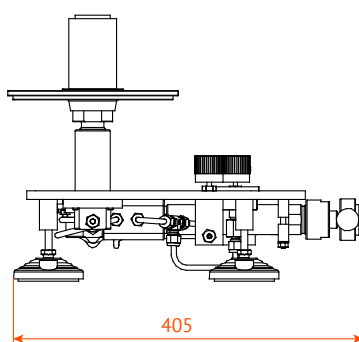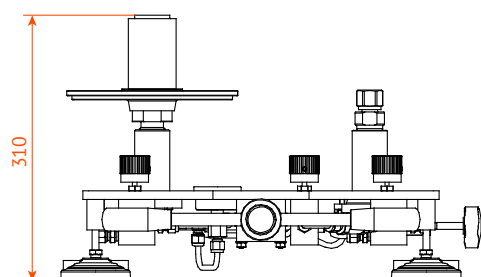


Дополнительные приспособления



Устройство электропривода вращения поршня ИПС
для облегчения работы и увеличения срока службы прибора



Электронный статоскоп
для проверки грузопоршневых манометров

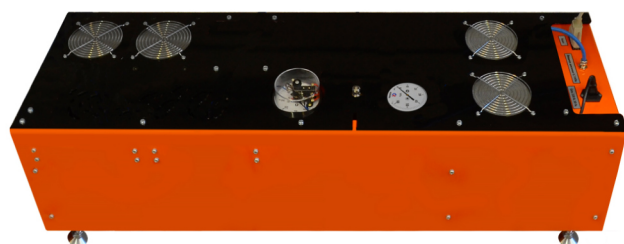

Внешние источники создания давления до 16 МПа и разряжения
(компрессоры, усилители давления, вакуумные насосы) с оснасткой для подключения

Свидетельство об утверждении типа средств измерения Российской Федерации №64136 от 08.11.2016 г., внесены в Госреестр средств измерения РФ под номером 52 506-16.

Сертификат о признании утверждения типа средств измерения Республики Казахстан №9764 от 30.09.2013, внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений под номером KZ.02.03.05458 2013/52506-13.

Сертификат об утверждении типа средств измерения Республики Беларусь №8792 от 31.10.2013, внесены в государственный реестр средств измерения под номером РБ 03 04 5275 13.

Поверка осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП АП-01-2016. Межповерочный интервал 2 года.

Комплект поставки**Стандартная поставка:**

- устройство для создания давления;
- измерительная поршневая система в футляре (с устройством электропривода вращения для МГП-0,2 и МГП-0,5);
- один набор грузов в выбранных единицах измерения, изготовленный для местного ускорения свободного падения в ящике для хранения;
- комплект фитингов для присоединения поверяемых средств измерения с резьбами: M20×1,5 – 1 шт; M12×1,5 – 1 шт; G½ – 1 шт; G¼ – 1 шт;
- комплект уплотнительных резинометаллических колец;
- комплект ЗИП;
- паспорт;
- свидетельство о первичной поверке;
- программное обеспечение для автоматического расчета создаваемого давления, масс грузов и влияния внешних факторов на результат измерений.

По дополнительному заказу:

- дополнительные ИПС для расширения диапазона измерения;
- устройство электропривода вращения поршня ИПС;
- электронный статоскоп для поверки грузопоршневых манометров;
- внешние источники создания давления до 16 МПа и разряжения (компрессоры, усилители давления, вакуумные насосы) с оснасткой для подключения;
- дополнительный набор грузов в других единицах измерения.

Пример заказа:

МГП-100/0,02/МПа/9,8145 – Манометр газовый грузопоршневой серии МГП, верхний предел измерения 10 МПа, предел основной погрешности измерения 0,02, комплект грузов в «МПа», ускорение свободного падения в районе эксплуатации 9,8145 м/с².